

Données sur le diabète : connecté pour des résultats.



Vos patients sont uniques. Leur traitement du diabète doit l'être aussi. L'utilisation de l'application mySugr® connectée à un glycomètre Accu-Chek® Guide soutient vos patients vivant avec un diabète de type 2 et améliore la gestion de leur glycémie¹.

Des données réelles, pour des résultats réels.

L'analyse rétrospective de données réelles indique une amélioration significative de la gestion du diabète chez les patients avec un diabète de type 2 qui utilisent un glycomètre connecté à l'application mySugr.

3 274 patients avec un diabète T1 et T2*
597 sont originaires du Canada (29,31% T1 et 70,69% T2)

9 pays en Europe et au Canada²

*T1 = diabète de type 1, T2 = diabète de type 2

Critères d'inclusion


Les patients avec un diabète T1 ou T2 ont été enrôlés entre mars 2013 et mai 2022. Ils étaient très engagés dans la prise en charge de leur diabète, enregistrant au moins deux résultats de mesures de glycémie par jour sur 14 jours durant une période de 30 jours.

Analyse rétrospective

L'impact sur l'HbA1c³ estimée (eHbA1c) et le pourcentage de mesures dans l'intervalle ont été calculés après 4 mois de connexion du glycomètre à l'application mySugr.



Réduction de l'HbA1c estimée

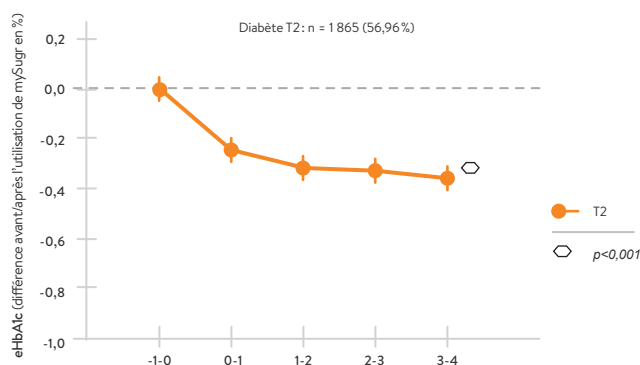


Temps écoulé depuis la connexion de mySugr et du glycomètre (en mois)

Contrôle amélioré de la glycémie

Une réduction statistiquement significative de 0,35 % de l'eHbA1c a été observée après 4 mois de connectivité entre le glycomètre et l'application mySugr chez les patients avec un diabète T2. Une amélioration significative a également été observée chez les patients dont l'eHbA1c initiale était > 7,5% (baisse de 0,58%), et encore plus chez ceux dont l'eHbA1c initiale était > 9% (1,76%).

Mesures de glycémie – patients avec un diabète T2

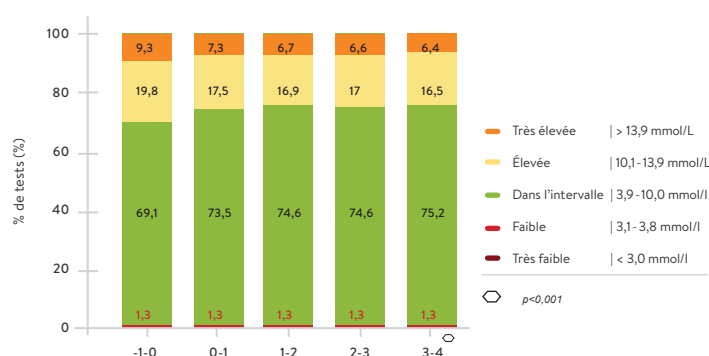

Temps écoulé depuis la connexion de mySugr et du glycomètre (en mois)

Hausse du pourcentage de mesures dans l'intervalle

Le pourcentage de mesures de glycémie dans l'intervalle chez les patients avec un diabète T2 a augmenté de 6,13 points de pourcentage grâce à la connectivité de mySugr, déjà observé après un mois de connexion entre l'application et le glycomètre.

1. Mayoral R, et al. Real World Data Analysis shows a Significant Improvement on Glycemic Management When Using a Blood Glucose Meter Connected with a Mobile Health Application in People with Diabetes. 15^e conférence internationale sur les technologies et traitements avancés du diabète (ATTD), Berlin, 2023. Poster n° 616.
2. Espagne, Portugal, Canada, Pays-Bas, Belgique, Danemark, Suède, Norvège, Finlande et Royaume-Uni.
3. Nathan DM, Kuenen J, Borg R, Zheng H, Schoenfeld D, Heine RJ, A1c-Derived Average Glucose Study Group. Translating the A1c assay into estimated average glucose values. Diabetes Care. 2008 Aug;31(8):1473-8.
4. Au 19 juin 2023.
5. Note moyenne de l'application dans l'App Store et Google Play Store dans le monde entier, 01-03-2023, 31-05-2023.



MYSUGR et ACCU-CHEK GUIDE sont des marques de commerce de Roche.
Toutes les autres marques et noms de produits sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.
© 2023 Roche Soins du diabète CA-1730



Visitez AppmySugr.ca